Camilla silla plegable PA-21

Manual de instrucciones

PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

1. Introducción manual

Aquí se menciona parte del manual, lea atentamente la descripción, ya que proporcionó información sobre el uso seguro y los procedimientos de mantenimiento de información importante. Las imágenes y descripciones del manual no son vinculantes, "PROMEBA" tiene el derecho de modificar cualquier información. En el manual, el propósito es actualizar el manual en la calidad del producto. El manual de gráficos e imágenes es solo un ejemplo, los productos también pueden mejorarse aún más.

2. Alcance aplicable

Se utiliza principalmente para hospitales, deportes, ambulancias y campos de batalla que llevan pacientes y personas heridas wound

3. Características

3.1 stretch La camilla con estructura plegable, el volumen es pequeño después de plegado.

3.2 、 Las camillas tienen dos ruedas plegables y dos pies plegables.

3.3 、 La camilla se puede plegar como silla.

3.4 、 La camilla está equipada con cinturones de seguridad para garantizar la seguridad de los pacientes en el proceso de traslado.

3.5 、 Está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y materiales de cuero oxford. Se caracteriza por ser liviano, pequeño, fácil de transportar, seguro y fácil de esterilizar.

3.6 、 Se puede guardar en el banco después de usar, ahorrar espacio de almacenamiento.

4. Parámetros técnicos

Modelo	PA-21
Medida desplegada (L×W×H)	190×53×22cm
Medida plegada (L×W×H)	103×53×22cm
Peso	15kg
Carga maxima	160kg

5. Método de uso

5.1、Cuando transfiera a los pacientes, primero expanda la camilla, luego presione el botón de posición, saque las ruedas y los pies a la posición de la superficie 90 °. （Según la imagen 1、2、3)

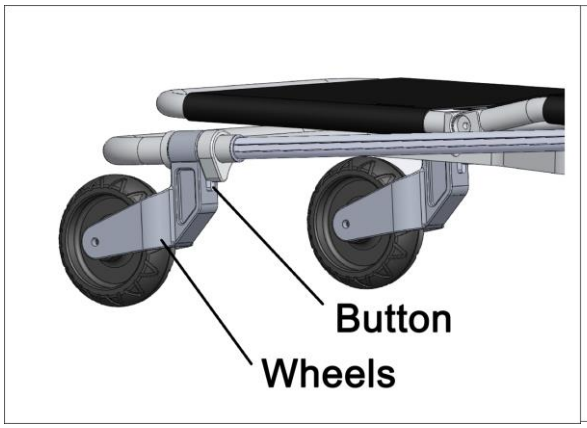

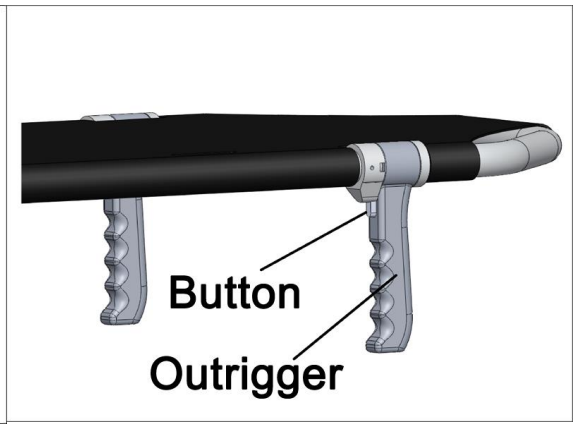

Foto 3

5.2、Los pacientes recostados en la camilla y apretados los cinturones de seguridad.

5.3、Al doblar la camilla como una silla, de acuerdo con la imagen 4, expanda primero la camilla y luego dóblela como una silla.Después del uso, vuelva a colocar la camilla en posición plana, pise la barra inferior y sostenga el estabilizador, jale hacia arriba hasta que la superficie esté plana (según la imagen 4)

Foto 4

5.4、Almacenamiento: de acuerdo con la imagen 5

Foto 5

6. Precauciones

1 、 Si la superficie de la camilla está dañada, sustitúyala de inmediato.

2 、 Se deben usar cinturones seguros para prevenir lesiones secundarias en pacientes.

7. Mantenimiento

1 、 Mantener limpio como rutina (incl. Desinfectar)

2 、Verifique los cinturones de seguridad en la camilla después de usarlos durante un período de tiempo. Y si la correa está dañada, debe reemplazarse, si la tuerca y el tornillo de acero están sueltos, apriételos.

3 、 Acerca de las partes de conexión y rotación de las camillas ， Si hay un bloqueo grave, agregue aceite cuando sea necesario

8. Almacenamiento

1 、 Guarde esta camilla en lugar de entornos a prueba de humedad y sin corrosión.

2 、 Almacenamiento, transporte, como se muestra en el cuadro de apilamiento**9. Transporte**

1 、 Ser transferido por herramientas de transporte comunes ： avión 、 nave o carretera.

2 、 Camilla se puede manejar manualmente

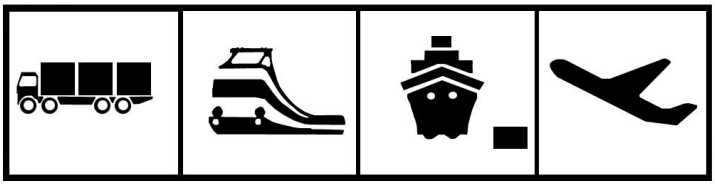

10. Embalajes y accesorios

1 、bag bolsa de nylon más un embalaje de cartón entero

2 、 Adjuntos: Certificado de inspección y manual del usuario.