Manual de Instruciones PA-01/PA-02/PA-17/ PA18

Resucitador manual con tubo de oxígeno, bolsa de reserva y válvula limitadora de presión.

El resucitador manual está disponible:

□ Resucitador manual SILICONE

□ Resucitador manual de PVC

□ Resucitador manual SEBS

□ adulto

□ Pediátrico (niño)

□ Infante.

El resucitador manual está disponible con o sin máscaras.

No estéril

100% libre de látex.

Los ftalatos se ajustan a la normativa REACH de la UE.

Uso previsto

El resucitador está destinado a la resucitación pulmonar.

El rango de aplicación para cada versión es:

□ Adulto: Adultos y niños.

□ Pediátrico: niños y bebés.

□ Infantil: Infantes y recién nacidos.

El reanimador se puede utilizar como normal para el suministro continuo de oxígeno y la ventilación asistida.

Estructura de montaje

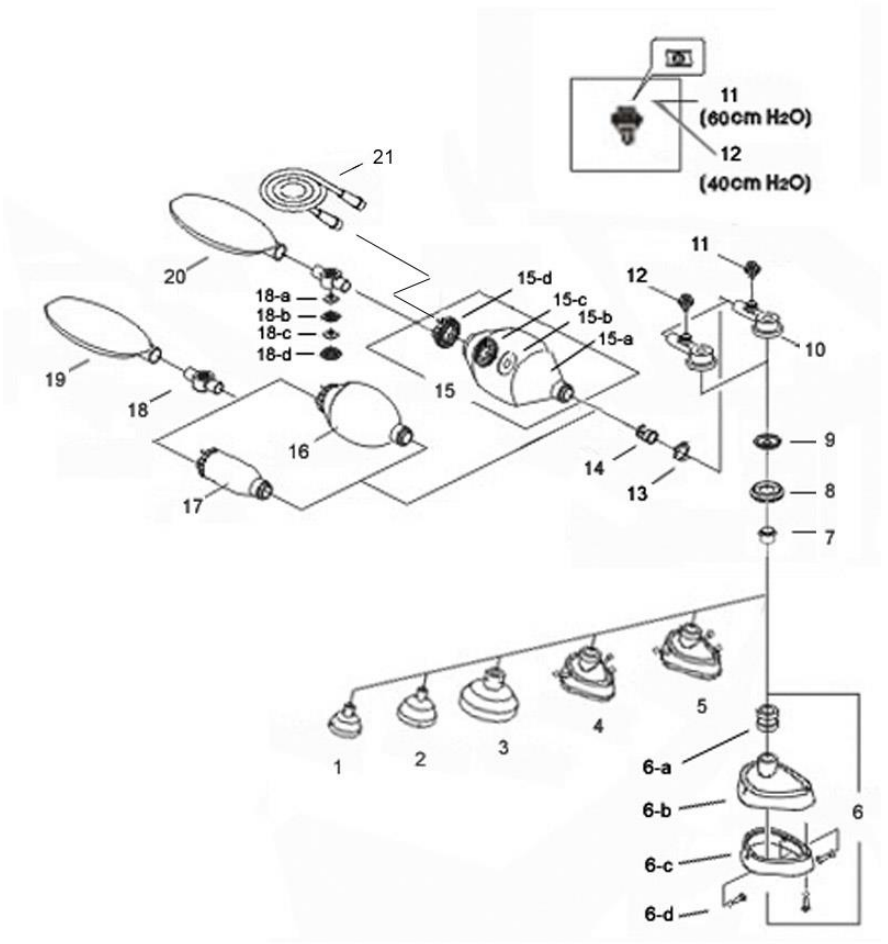

Función de reanimación

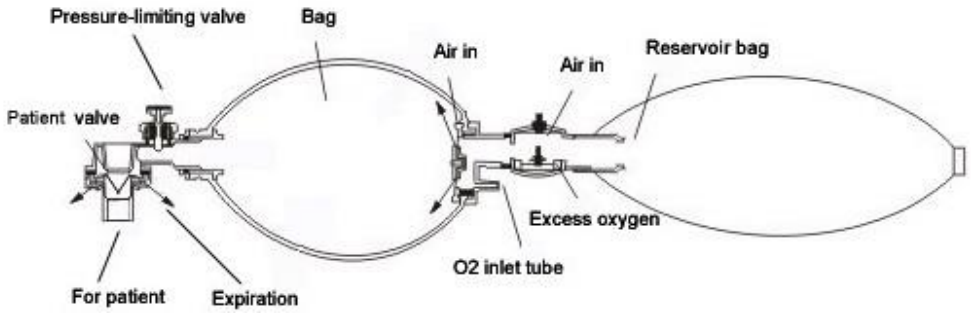

Precaución ⚠

1. Este producto debe ser utilizado por personal bien entrenado en las técnicas de resucitación pulmonar.
2. Despeje las vías respiratorias del paciente antes de usar el resucitador manual.
3. Compruebe siempre el correcto funcionamiento del reanimador.
4. Verifique la acción correcta de la válvula. Verifique que el paciente esté siendo ventilado observando un aumento y caída alternos del pecho y el color de los labios y la cara del paciente durante la reanimación.
5. Realice siempre una prueba funcional del resucitador después de desembalar y ensamblar.
6. No utilice el resucitador en atmósferas tóxicas o peligrosas.
7. No se debe usar aceite o grasa cerca del equipo de oxígeno, ya que puede producirse un incendio.
8. No fume ni use llamas abiertas cuando el oxígeno está en uso; puede provocar un incendio.
9. El resucitador manual de PVC / SEBS es desechable. Es solo para uso en un solo paciente. No se debe reprocesar. Si reutilizable puede causar infección cruzada entre los pacientes.

Configurar resucitador manual:

Extender por completo la bolsa de reanimación (versión para adultos y pediátrica). Antes de utilizar el reanimador. Acción de la válvula visualmente adecuada mientras se aprieta el resucitador. Conecte la válvula del paciente a la salida de la máscara. Si está resucitando con una alta concentración de oxígeno, extienda completamente el tubo de oxígeno, conecte el adaptador de la boquilla de oxígeno a la fuente de oxígeno adecuada. Conecte la bolsa de depósito. Ajuste el flujo de oxígeno para que no exceda los 15 LPM o por orden de un médico.

Prueba de funcionamiento correcto

1. Conecte un pulmón de prueba de 1,5 litros al conector del paciente. Apriete y suelte el resucitador varias veces y compruebe que el pulmón de prueba se llena. Durante la ventilación continua, la expansión y la relajación de la bolsa de prueba deben ser visibles. De lo contrario, compruebe el obturador de la válvula de entrada y el obturador de la válvula del paciente.
2. Cierre la válvula limitadora de presión y el conector del paciente con un pulgar mientras comprime firmemente la bolsa del resucitador para verificar el ajuste y el ajuste correcto de la válvula.
3. Abra la válvula limitadora de presión y cierre el conector del paciente con un pulgar. Ahora se debe activar la válvula limitadora de presión y debería ser posible escuchar el flujo espiratorio de la válvula.
4. Bolsa de depósito: Suministre un flujo de gas de 3.0 L / min al tubo de oxígeno. Compruebe que el depósito se llena. De lo contrario, verifique la integridad de los dos obturadores de la válvula, o un depósito roto o un tubo de oxígeno bloqueado.

Operating instructions

Boca abierta, vía aérea clara de todo exterior.
Materia y fluidos. El uso de una emergencia.
Se recomienda el aspirador.
Incline la cabeza completamente hacia atrás
Barrios y empujar la mandíbula hacia arriba o
n el cuello estirado para abrir la vía aére.a

Para ayudar a la ventilación puede
Ser beneficioso para insertar un artificial.
aerovía. Tenga cuidado de que no
empujar la lengua hacia atrás y por lo tanto
obstruct the throat.

1. Mantener la mascara estrechamente a la cara de la víctima cubriendo boca y nariz, inclinación.
La cabeza completamente hacia atrás, sujetando la máscara
Mano levantando la mandíbula hacia adelante. Exprimir
La bolsa de forma inteligente y ver el pecho expandirse..

6

2. Hacer presión sobre la bolsa de repente y permitir que el cofre desinflar. Repita 12-20 veces por minuto, o 30 veces en el caso de infantes.



Si se encuentra una resistencia continua a la insuflación, verifique si hay obstrucción de la vía aérea o corrija la inclinación de la cabeza hacia atrás. Si no se logra una ventilación adecuada con el reanimador, vuelva inmediatamente a la ventilación con aire expirado (boca a boca o boca a nariz).

5. La frecuencia de ventilación correcta puede variar. Por favor, siga la frecuencia de ventilación actual recomendada por las directrices nacionales o internacionales.

6. Si el paciente vomita durante la ventilación con mascarilla, despeje inmediatamente de las vías respiratorias el vómito, luego comprima libremente la bolsa varias veces antes de reanudar la ventilación.

7. Versión para adultos: la válvula limitadora de presión está abierta a 60 cmH2O.

Versión pediátrica e infantil: la válvula limitadora de presión está abierta a 40 cmH2O.

⚠ *Precaución: Se escucha un silbido cuando se abre el dispositivo..*

8. Si se requieren presiones más altas, presione y gire el botón mientras aprieta la bolsa, la válvula limitadora de presión se anulará

⚠ *Precaución: Las altas presiones de ventilación pueden causar rotura pulmonar o distensión estomacal en ciertos pacientes.*

9. Administre la referencia de oxígeno a "Especificaciones" o de acuerdo con las indicaciones médicas.

Desmontar:

Referencia del resucitador de silicona arriba de “Estructura de ensamblaje”: Desatornille “8” de “10”, quite “10” de “14”, Destornille “15-c” de “15-d”.

No desmonte "7" de "8",

Montar:

Referencia de resucitador de silicona arriba de "Estructura de ensamblaje" y "Función de resucitador".

Limpiar y esterilizar:

El resucitador de silicona (excepto el tubo de O2 y la bolsa de reserva) se lava con agua de Javel al 0,2% y se enjuaga con agua limpia, luego se envía en autoclave 15 minutos hasta 134 ° C. El resucitador de silicona (máscara de silicona, bolsa y válvulas) es reutilizable 20 veces solamente. El tubo de oxígeno y la bolsa de reserva son desechables. Debe ser reemplazado antes de ser reutilizable.

El resucitador cumple con la norma: ISO 10651-4.

También cumple con la Directiva 2007/47 / CE y la Directiva del Consejo MDD / 93/42 / CEE sobre dispositivos médicos.